

■適用




■量測範例



■量測盲孔時的參考尺寸

量測範圍 (mm)	L ₃ (mm)	L ₅ (mm)
12~20	2.6以下	3.5
20~30	3.4以下	5.2
30~50	3.4以下	10.0
50~100	3.4以下	14.0
100~300	19.6以下	13.8




■亦可製作為特殊內徑形狀專用
詳情請參閱C-45頁。

內徑測定器

368系列 II 型內徑測微器 (三點式內徑測微器) HT2-R

- 價格實惠的普及型內徑測微器。
- 具有與鈦塗層內徑測微器同等的精度。
- 環規請參閱C-43頁。
- 附定壓裝置，減少各作業人員間的差異，可進行穩定的量測。
- 可連接延長桿 (選購品) 量測深孔。

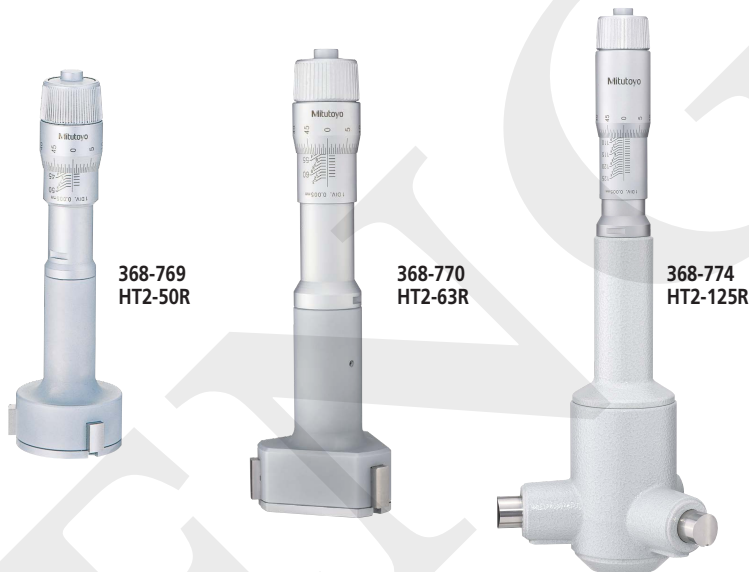

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	刻度 (mm)	最大容許誤差 J _{MPE} (μm) ※	延長桿 (選購品)
368-764	HT2-16R	12~16	0.005	±3 (最大差3)	952621 (150 mm)
368-765	HT2-20R	16~20			
368-766	HT2-25R	20~25			
368-767	HT2-30R	25~30			
368-768	HT2-40R	30~40			
368-769	HT2-50R	40~50			
368-770	HT2-63R	50~63		±4 (最大差4)	952623 (150 mm)
368-771	HT2-75R	62~75			
368-772	HT2-88R	75~88			
368-773	HT2-100R	87~100			
368-774	HT2-125R	100~125			
368-775	HT2-150R	125~150			
368-776	HT2-175R	150~175		±5 (最大差5)	
368-777	HT2-200R	175~200			
368-778	HT2-225R	200~225			
368-779	HT2-250R	225~250			
368-780	HT2-275R	250~275			
368-781	HT2-300R	275~300			
				±6 (最大差6)	

※：最大差為全量測面接觸時之指示誤差最大值與最小值的差。

註1：環規為選購品。

註2：無法使用標準附屬以外的測頭部變更量測範圍。(不在精度保證範圍內。)

■外觀尺寸圖

單位：mm

型號	L ₂	L ₁
HT2-16R, 20R	82	126~130
HT2-25R, 30R	94	137~142
HT2-40R, 50R	102	145~155
HT2-63R, 75R, 88R, 100R	105	150~163
HT2-125R, 150R, 175R, 200R, 225R, 250R, 275R, 300R	161	227~252

註：外觀尺寸依量測範圍而異。



內徑測定器

368系列 II 型內徑測微器（三點式內徑測微器） HT2-R

●完整套組




- 368-991
HT2-20RST**
- 量測範圍：12~20 mm
 - 刻度：0.005 mm
 - 套組內容：本體/12~16 mm 1支、16~20 mm 1支，環規（ $\phi 16$ ）1個，延長桿（150 mm）1支，扳手 2支，內六角扳手 1支



- 368-992
HT2-50RST**
- 量測範圍：20~50 mm
 - 刻度：0.005 mm
 - 套組內容：本體/20~25 mm 1支、25~30 mm 1支、30~40 mm 1支、40~50 mm 1支，環規（ $\phi 25$ 、 $\phi 40$ ）各1個，延長桿（150 mm）1支，扳手 2支，內六角扳手 1支



- 368-993
HT2-100RST**
- 量測範圍：50~100 mm
 - 刻度：0.005 mm
 - 套組內容：本體/50~63 mm 1支、62~75 mm 1支、75~88 mm 1支、87~100 mm 1支，環規（ $\phi 62$ 、 $\phi 87$ ）各1個，延長桿（150 mm）1支，扳手 2支，內六角扳手 1支



- 368-994
HT2-200RST**
- 量測範圍：100~200 mm
 - 刻度：0.005 mm
 - 套組內容：本體/100~125 mm 1支、125~150 mm 1支、150~175 mm 1支、175~200 mm 1支，環規（ $\phi 125$ 、 $\phi 175$ ）各1個，延長桿（150 mm）1支，扳手 2支，內六角扳手 1支



標準附屬品（另外包裝）
環規（ $\phi 125$ 、 $\phi 175$ ）

註：無法使用標準附屬品以外的測頭部變更量測範圍。（不在精度保證範圍內。）

Mitutoyo

■適用

